



# RAE-Sep™ Tube Cartridge Für MultiRAE Benzene




**1**

Die Patrone so einsetzen, dass die "quadratische" Taste an dem Pfeil am Eingang ausgerichtet ist




**2**

Im Uhrzeigersinn festziehen




**3**

Die "pfeilförmige" Taste muss an dem Pfeil am Eingang ausgerichtet sein



**4**

Staubfilter installieren



**5**

Die Patrone ist jetzt einsatzbereit



**WARNUNG**



Die RAE-Sep Tube Cartridge darf nur mit dem MultiRAE Benzene verwendet werden. Die Verwendung eines anderen Detektors, einschließlich Standarddetektoren von MultiRAE oder Produkte anderer Hersteller, führt zu einer ungenauen Benzolerkennung oder -messung und kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

**HINWEIS:** Die Gewährleistung für die RAE-Sep Tube Cartridge wird von RAE Systems nur übernommen, wenn sie zusammen mit dem MultiRAE Benzene verwendet wird.

TVOC



**6**


Benzol-Modus wählen ("B" wird angezeigt)



Benzol


**7**

Patronenoberteil drehen, um Röhren 1 zu wählen




**8**

Auf die gelben Tasten an beiden Enden des gewählten Röhrens drücken, um die Enden aufzubrechen

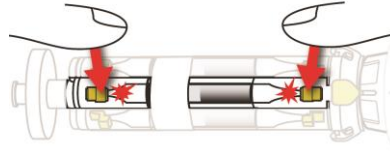

**9**

Darauf achten, dass die Patrone fest sitzt und die Pfeile aneinander ausgerichtet sind



**10**

Sicherstellen, dass der Benzol-Modus ausgewählt wurde



RAE Systems von Honeywell  
www.raesystems.com

Verkaufsbüros weltweit

USA/Kanada 1.877.723.2878

Europa +800.333.222.44/+41.44.943.4380

Naher Osten +971.4.450.5852

China +86.10.5885.8788-3000

Asien-Pazifik +852.2669.0828

P/N: M01-4051-000  
Rev. A Juni 2015